PRESTIGE
SU ALIADO EN EL CUIDADO DE LA SALUD

Diagnostico

OTOSCOPIO PROFESIONAL
REF: FMO-008-8400
MARCA: STRONG MEDICAL

Otoscopio convencional de fibra óptica luz amarilla de uso profesional de 2,5 Voltios. Utilizado para examen de oídos, conducto auditivo externo y el tímpano

1 Año GARANTIA



Incluye Estuche



Incluye Especulos

Otoscopio

Cra 36 #63A 29 Br Rosario
comercial@ciprestige.com
www.ciprestige.com
3123505610
PBX: (1) 4660170 - 4660754

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Iluminación	Iluminación de fibra óptica
Amplificación	3 X
Baterías	2 AA (No incluidas)
Operación	Temperatura 10°C – 35°C Humedad 30% - 75%
Almacenamiento y Transporte	Temperatura -20°C – 70°C Humedad 10% - 90%
Registro INVIMA	2017DM016809

CARACTERÍSTICAS OTOSCOPIO

- Interruptor tipo clip on/off
- 2 Baterias AA (no incluida)
- Lente (2) aumenta aproximadamente 3x y puede girarse a un lado
- Incluye 10 espéculos (6 #2.5 y 4 de #4)
- Práctico estuche de transporte

DESCRIPCIÓN

1. Hendidura para especulo
2. Ventana de visualización
3. Conector del mango
4. Mango
5. Mango
6. Bombillo
7. Espéculos desechables
8. Espéculos reutilizables

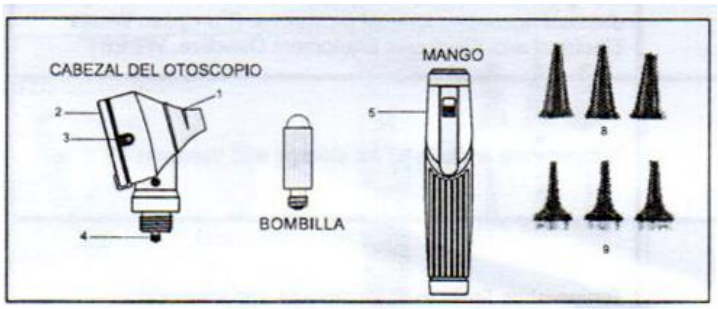

CABEZA OTOSCOPIO – USO

- **Espéculos:** El otoscopio solo se debe insertar en el canal auditivo cuando se puede desechar con una punta reutilizable o desechable instalada. Empuje la punta sobre el instrumento para que la proyección interna se enganche en la ranura (1). Gire a la derecha para bloquear.
- **Iluminación general:** El otoscopio se puede usar con o sin punta para la iluminación general
- **Cambiar la bombilla**
  - **F.O. Otoscopio:** primero desenrosque la cabeza del mango y tire de la bombilla (3) hacia abajo. Empuje la bombilla nueva.
  - **Otoscopio convencional:** gire la lente (2) hacia un lado y simplemente tire del bombilla hacia atrás fuera de la cabeza. Empuje una bombilla nueva.
- **Limpieza y esterilización:** Cabeza del otoscopio: limpie el exterior con un paño suave, el interior con un algodón brote, si es necesario Empapado en alcohol. Se permite la esterilización con gas. No remojar.

MANGOS – USO
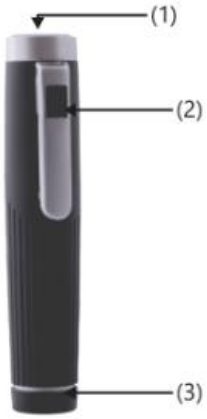
- **Rango de aplicaciones:** El mango de la batería del el oftalmoscopio MINI.
- **Baterías:** 2 pilas alcalinas (AA / LR 6)
- **Importante**: no utilice todas las baterías alcalinas de manganeso con litio ya que la vida útil de la bombilla se reducirá.
- **Conector del instrumento:** Rosca interna en la cabeza del mango (1).
- **Encendido:** Presione el interruptor (2) hacia abajo: aparece un indicador verde.
- **Apagando:** Empuje el interruptor hacia arriba.
- **Cambio de pilas:** Desenrosque la tapa del extremo (3) y agite las baterías viejas. Inserte pilas nuevas con el contacto positivo hacia la cabeza del mango.
- **Limpieza**
  - El mango se puede limpiar con un paño húmedo. (por ejemplo, detergente alcalino o pH neutro).
  - Para la desinfección de la superficie exterior, recomendamos la llamada desinfección de toallitas mediante el uso de detergentes, que son hechos para dispositivos médicos hechos de plástico.
  - No se permite la desinfección por pulverización o inmersión, así como la esterilización